




新浄化システム参考例

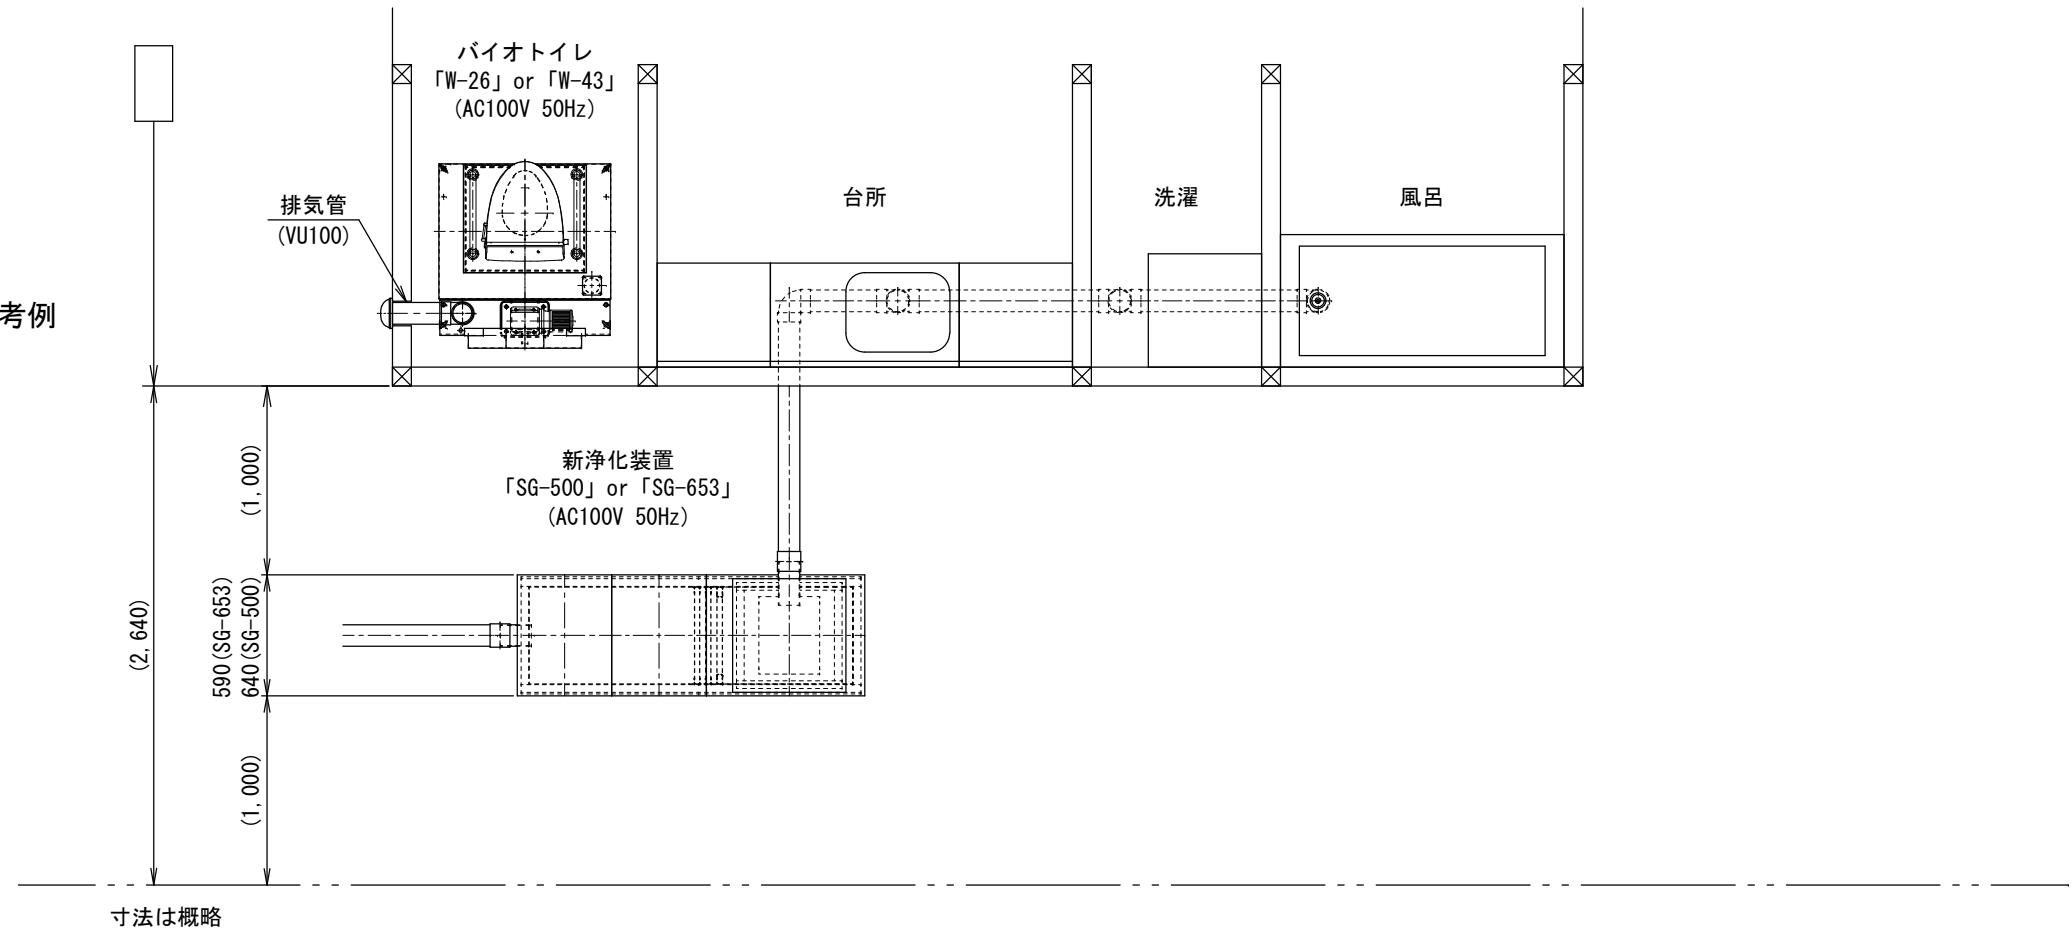


※. バイオトイレのおガクズ交換は1年に2~3回です。  
(排気管と中間ファンの点検も同様)

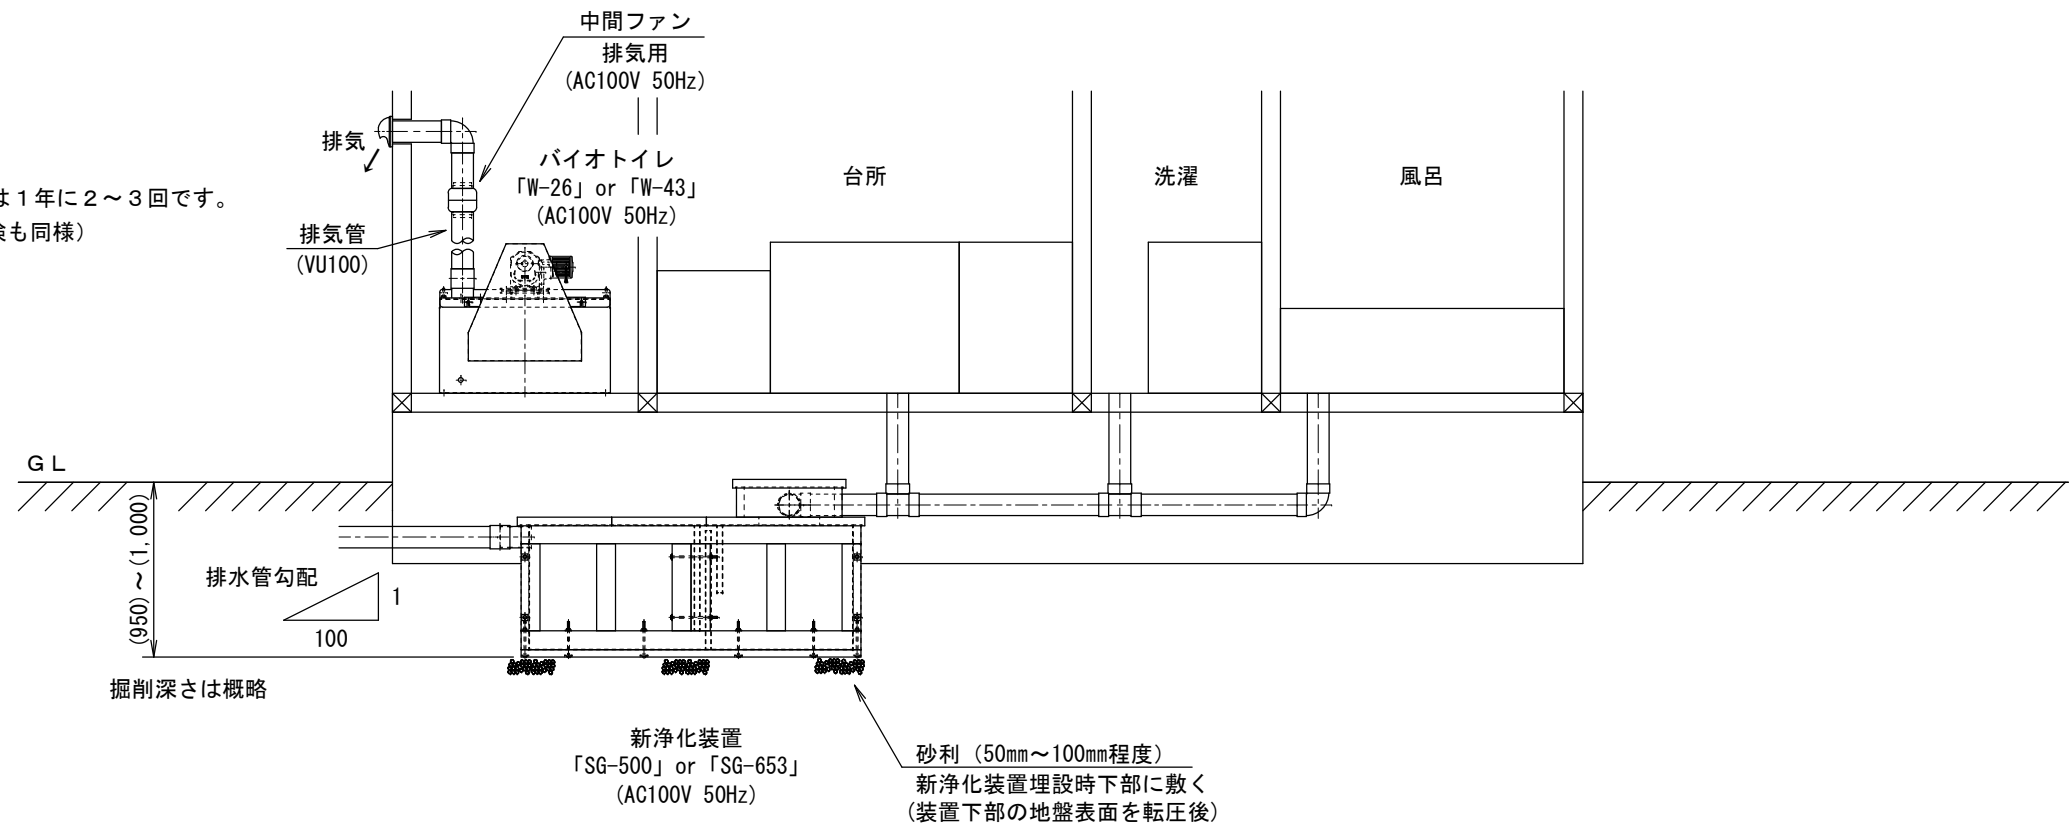

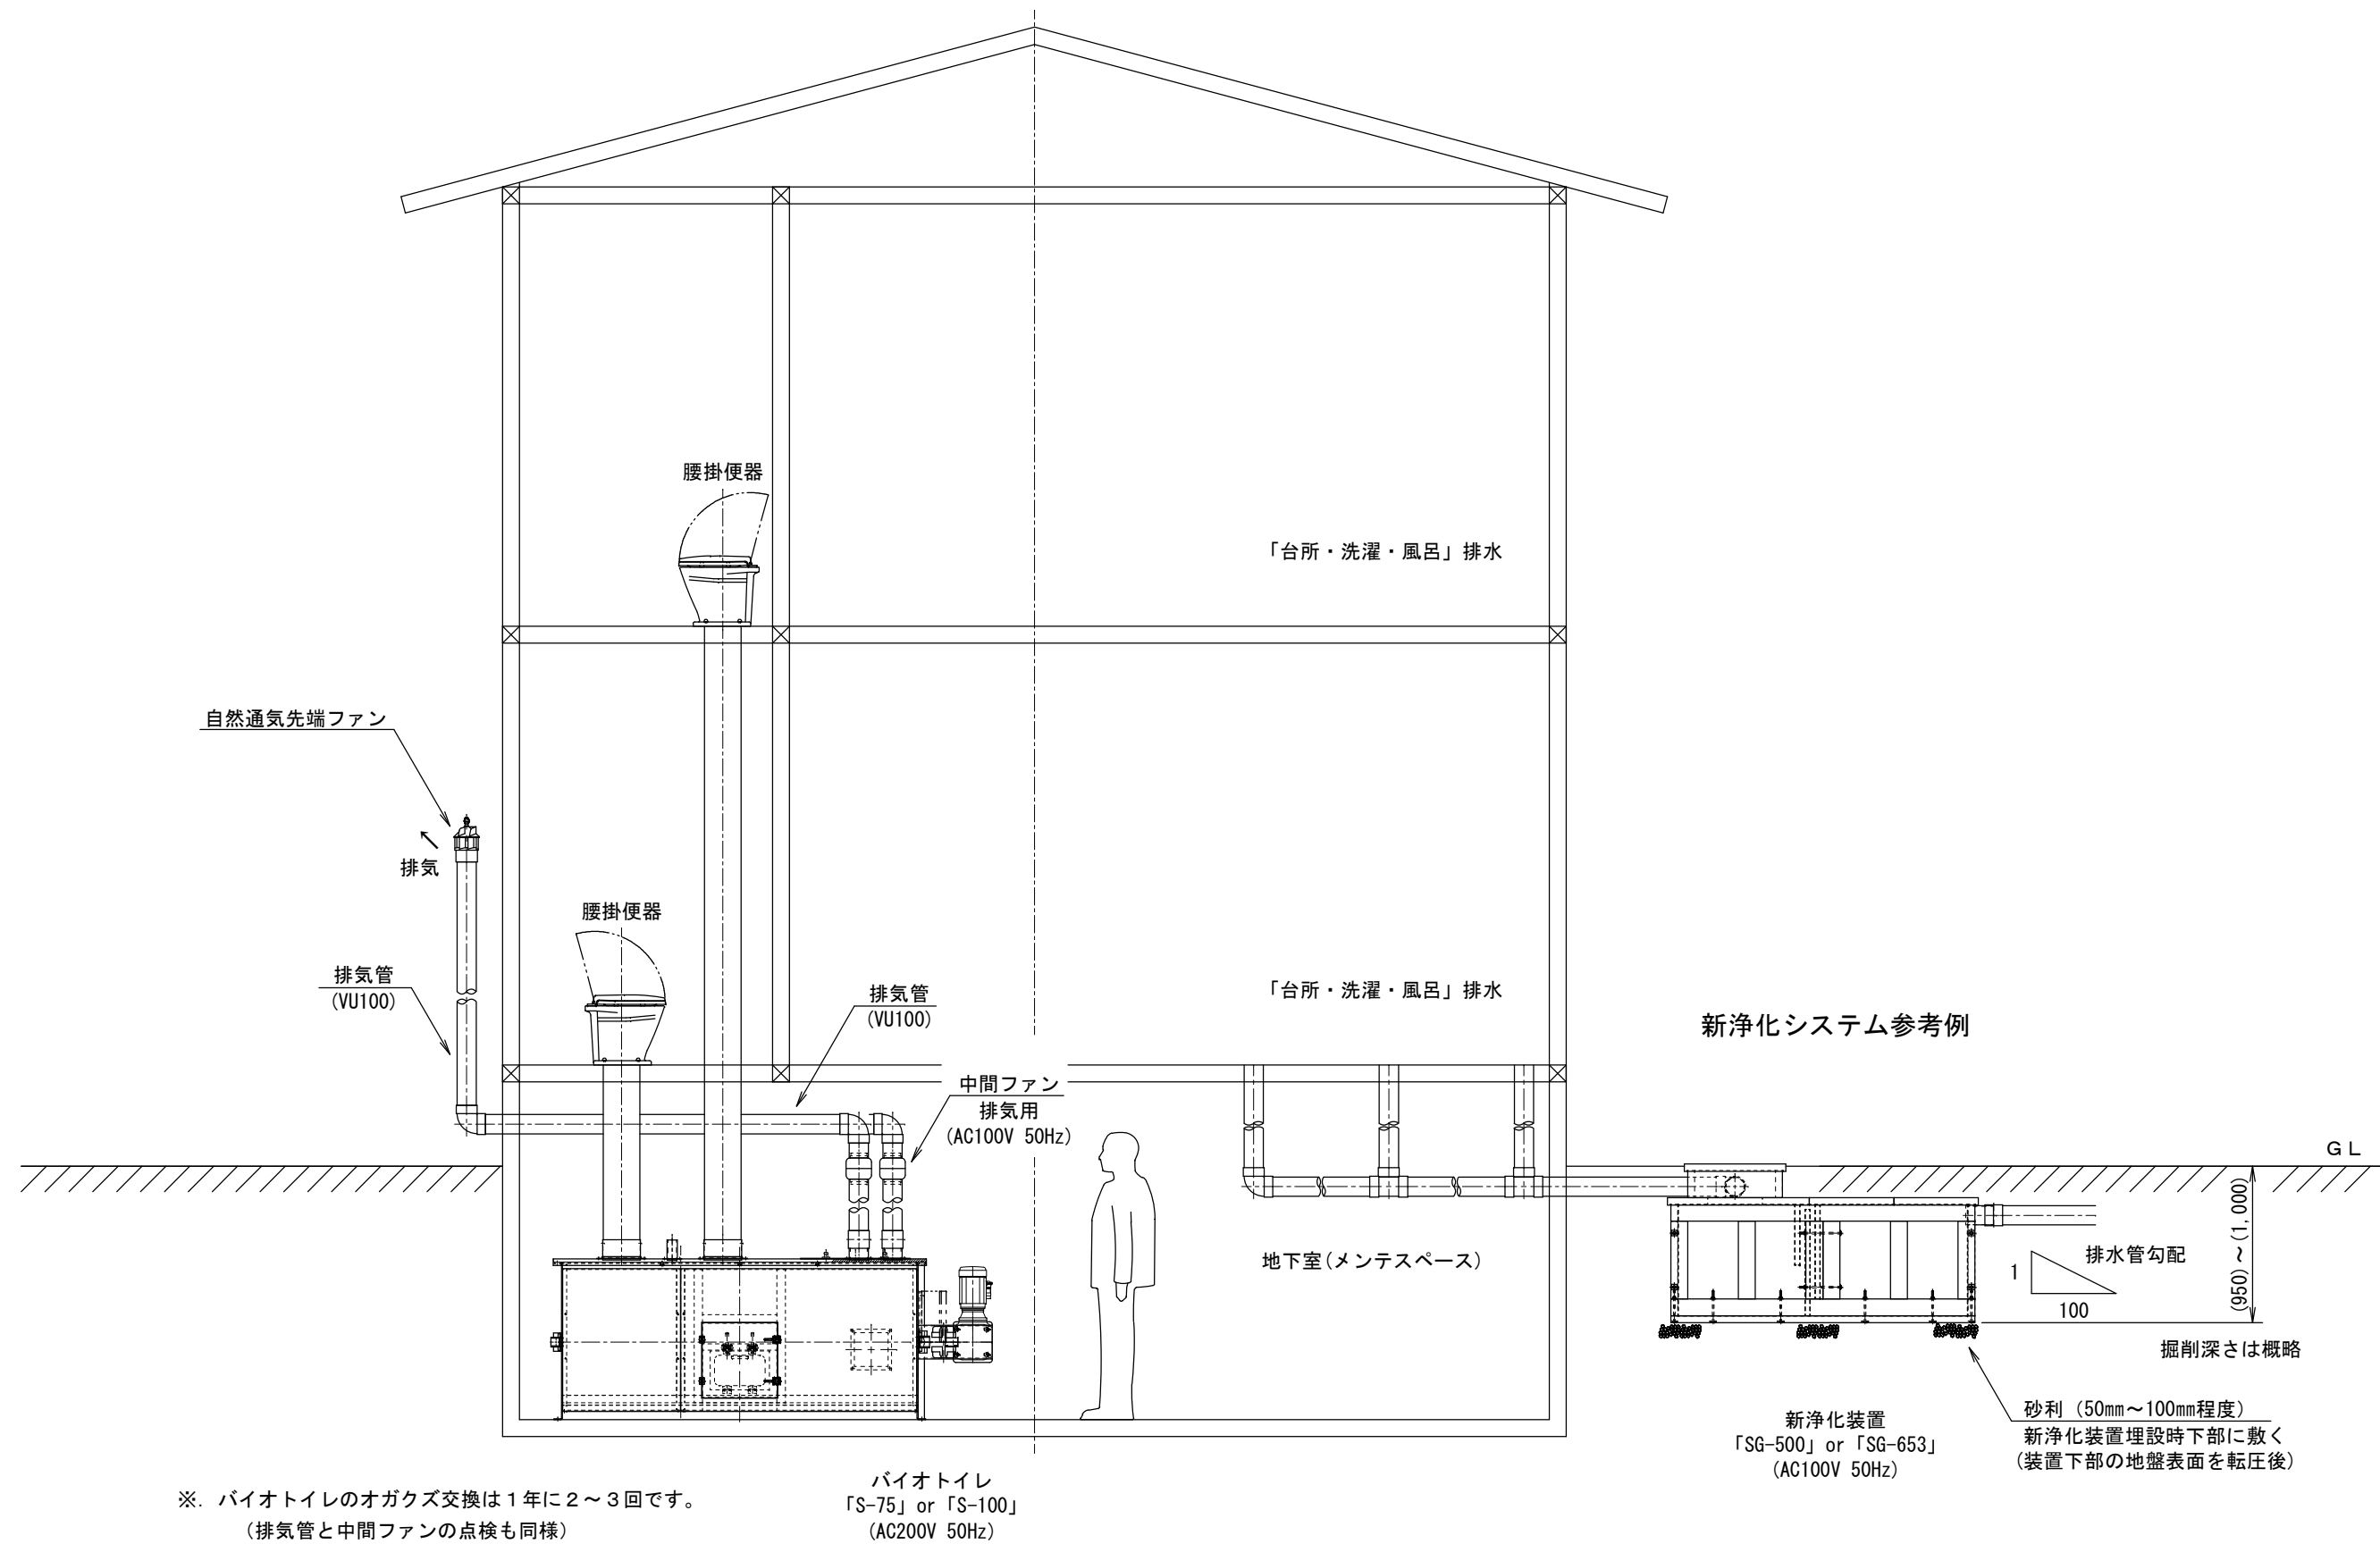

配置イメージ図「2」  
2013, 09, 05

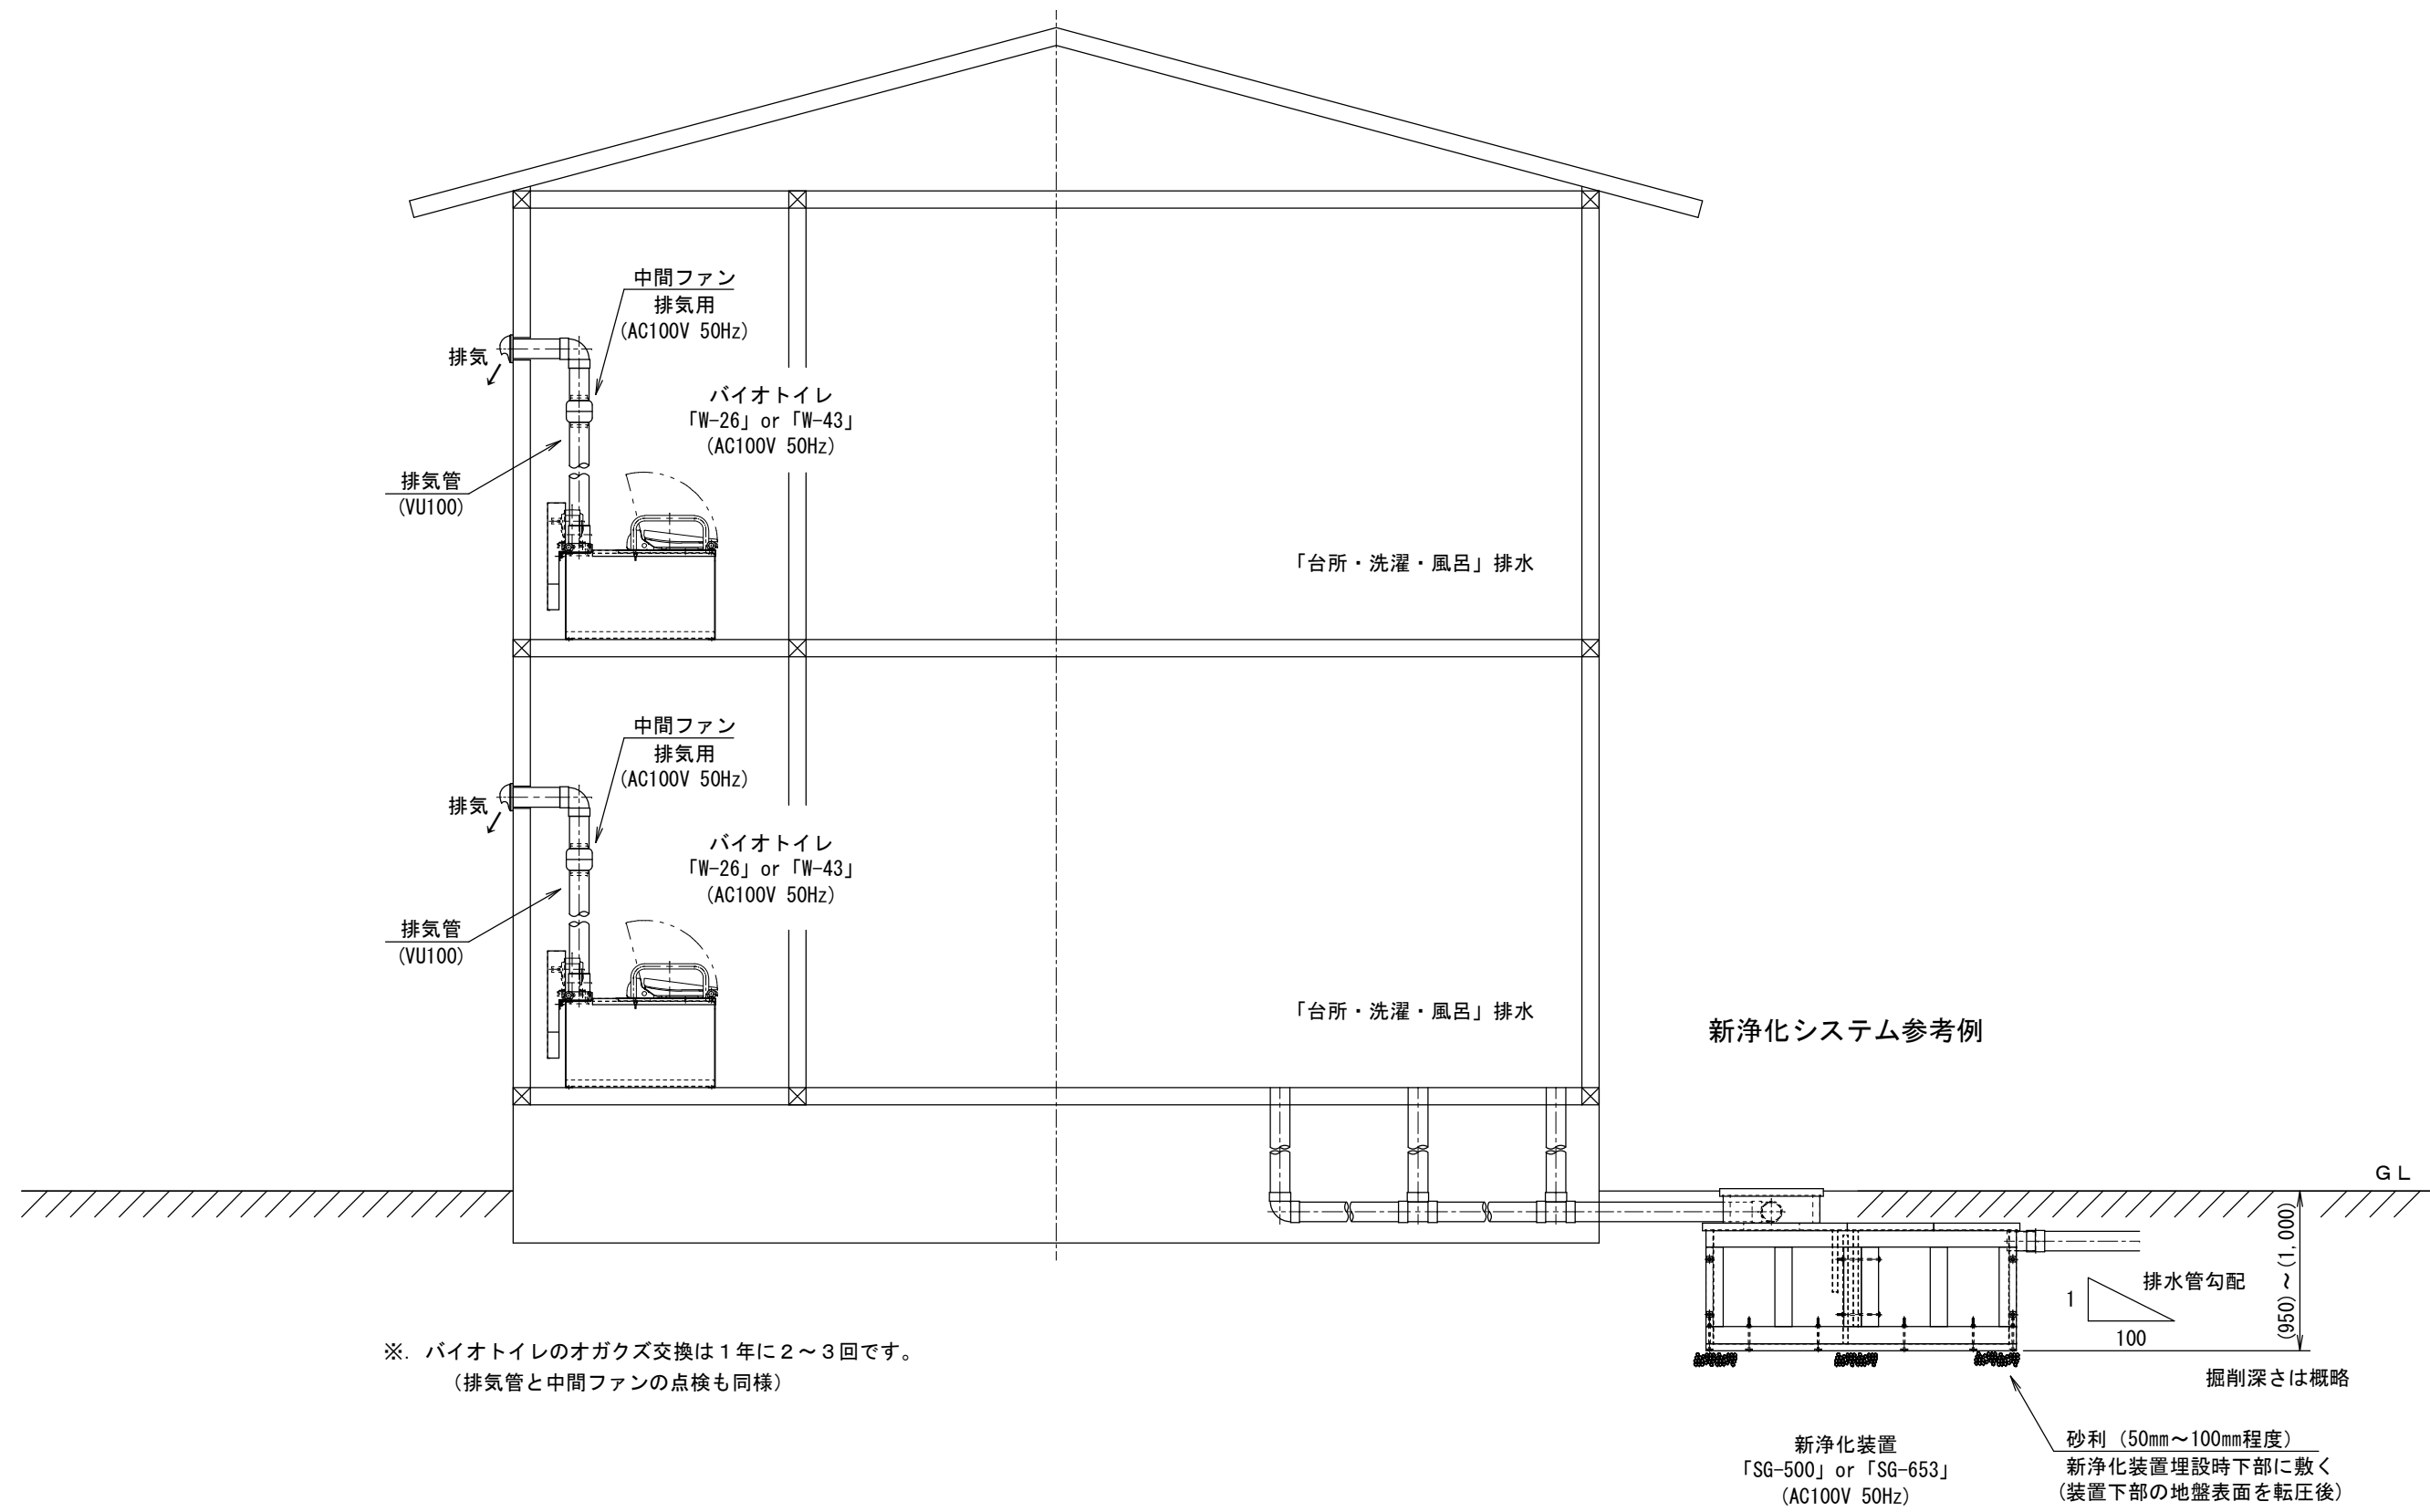

※. バイオトイレのオガクズ交換は1年に2~3回です。  
(排気管と中間ファンの点検も同様)

配置イメージ図「3」

2013, 09, 05